


セキュリティ関連情報

1. EOL/EOSについて

当該製品（リムセイブ MT-7500）における、EOL, EOS の定義を以下に示します。

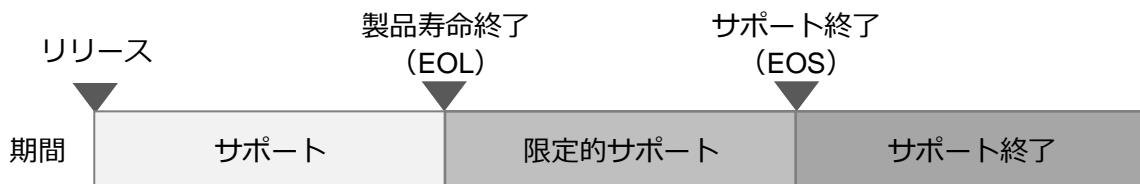

<EOL/EOS 方針>

EOL（製品寿命終了）：当該製品の最終号機の設置から 6 年

EOS（サポート終了）：当該機器 EOL から 4 年

<本製品の EOL/EOS 情報>

販売名	バージョン	製品寿命終了(EOL)	サポート終了(EOS)
リムセイブ MT-7500	すべて	当該製品の最終号機の設置から 6 年	当該機器 EOL から 4 年

※1:本情報は必要に応じて変更されることがあります。

2. 保守計画について

●サポート期間中（～EOL）

- 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。

●限定的サポート中（EOL～EOS）

- 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。
- 一般的な不具合等の解析依頼や修正については、当社により対応必要と判断した場合に対応します。
- 本期間で装置の買い替え、バージョンアップを検討してください（詳細については、当社の営業またはサービス担当者にお問い合わせください。）。

●サポート終了後（EOS 以降）

- 市販後監視の一環として脆弱性情報を監視しますが、薬事上の回収（改修）に該当する場

合を除き、脆弱性の修正を含むセキュリティアップデートの準備・提供は行いません。セキュリティに関する責任はお客さまへ移転されます。

- ・回収（改修）に該当はしないものの、製品に影響する深刻度が高い脆弱性（緊急性が高い脆弱性）については、情報を提供します。
- ・その他、情報提供を求められた場合は、セキュリティアドバイザリの開示を行います。

3. セキュリティインシデント発生時の対応

セキュリティインシデント発生時には、以下の対応をお願いいたします。

(1) 初期対応（ネットワークからの切り離し）

当社製品が接続されたネットワーク内で、セキュリティインシデントが発生した、またはその疑いがある場合、当社製品をネットワークから切り離してください。

また、当社製品の電源は切らないでください。

(2) 状況の把握・サービス担当者への連絡

以下の A～E の観点で、被害の範囲や状況を可能な範囲で確認し、サービス担当者に、これらの情報のご提供をお願いします。

- A. 医療機器の設定情報の不正な変更
- B. 診断・治療に対する不正な変更又は無効化
- C. 機密データの喪失、改竄又は開示
- D. 医療機器の機能停止、誤動作又は不正動作
- E. 他の機器・システムへの拡散

(3) 措置・復旧

医療機関内の管理者の判断に基づき、サービス担当者と連携して適切な措置を行ってください。バックアップデータ取得日の状態までの復旧はサービス担当者が実施します。

以上