


セキュリティ関連情報

1. EOL/EOS について

当該製品における、EOL,EOS の定義を以下に示します。

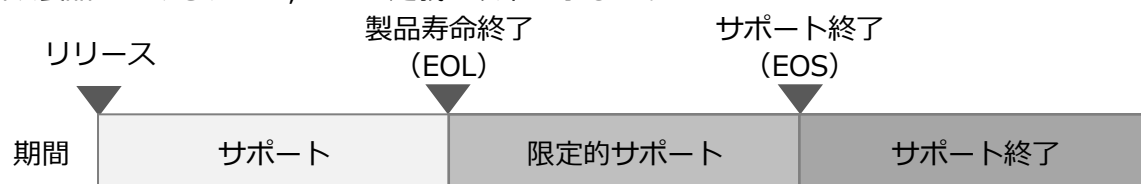

<EOL/EOS 方針>

EOL（製品寿命終了）：当該製品の設置から 6 年

EOS（サポート終了）：当該製品の販売終了から 8 年

<各製品の EOL/EOS 情報>

販売名	バージョン	製品寿命終了(EOL)	サポート終了(EOS)
電子内視鏡 EG-840N	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EG-840T	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EG-840TP	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EN-840T	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 ED-840T	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EB-840S	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EB-840T	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EG-860R	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
電子内視鏡 EC-860P/M	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年
超音波内視鏡 EG-740UT	すべて	設置から 6 年	当該製品の販売終了から 8 年

販売名	バージョン	製品寿命終了(EOL)	サポート終了(EOS)
電子内視鏡 EG-760R	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-760P-V/M	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-760R-V/M	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-760XP/L	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EG-760Z	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-760ZP-V/M	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-760Z-V/M	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EB-710P	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EB-710XT	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
超音波内視鏡 EB-710US	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EG-6500N	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EG-6600R	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-6600P	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-6600R	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EG-6600Z	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EC-6600ZP	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年

販売名	バージョン	製品寿命終了(EOL)	サポート終了(EOS)
電子内視鏡 ER-6400S	すべて	設置から6年	当該製品の販売終了から8年
電子内視鏡 EG-6400N	すべて	設置から6年	2032年9月25日
電子内視鏡 EG-740N	すべて	設置から6年	2031年9月30日

※1:本情報は必要に応じて変更されることがあります。

2. 保守計画について

●サポート期間中（～EOL）

- ・ 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- ・ 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。

●限定的サポート中（EOL～EOS）

- ・ 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- ・ 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。
- ・ 一般的な不具合等の解析依頼や修正については、当社により対応必要と判断した場合に対応します。

●サポート終了後（EOS以降）

- ・ 市販後監視の一環として脆弱性情報を監視しますが、薬事上の回収（改修）に該当する場合を除き、脆弱性の修正を含むセキュリティアップデートの準備・提供は行いません。セキュリティに関する責任はお客様へ移転されます。
- ・ 回収（改修）に該当はしないものの、製品に影響する深刻度が高い脆弱性（緊急性が高い脆弱性）については、情報を提供します。
- ・ その他、情報提供を求められた場合は、セキュリティアドバイザリの開示を行います。

3. セキュリティインシデント発生時の対応

セキュリティインシデント発生時には、以下のご対応をお願いいたします。

(1) 初期対応（ネットワークからの切り離し）

当社製品が接続されたネットワーク内で、セキュリティインシデントが発生した、またはその疑いがある場合、当社製品をネットワークから切り離してください。

また、当社製品の電源は切らないでください。

(2) 状況の把握・サービス担当者への連絡

以下の A～F の観点で、被害の範囲や状況を可能な範囲で確認及び現状を保全して、サービス担当者に、これらの情報のご提供をお願いします。

- A. 医療機器の設定情報の不正な変更
- B. 診断・治療に対する不正な変更又は無効化
- C. 機密データの喪失、改竄又は開示
- D. 医療機器の機能停止、誤動作又は不正動作
- E. 他の機器・システムへの拡散
- F. マルウェア感染の疑い

(3) 措置・復旧

医療機関内の管理者の判断に基づき、サービス担当者と連携して、ウイルススキャンやマルウェア除去等の適切な措置を行ってください。当社製品が正常に動作することを確認した後、管理者の判断により、ネットワークへ再接続して、製品の使用を再開してください。

以上